

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Estado de São Paulo

Plenário Alexandre Chauar

Rua Antonio Benedito de Almeida, 22

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapuí

Tel.: 3276-1488 – site: www.camarasarapui.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 712/2021

Autoria: Leticia Correa da Silva Martins | Sessão Ordinária: 04/08/21

EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Indico ao senhor Prefeito Municipal de Sarapuí, juntamente com o setor competente desta municipalidade, a possibilidade de realizar a manutenção do aparelho respirador, no Posto de Saúde. Segue foto em anexo.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação se faz necessária, pois o referido aparelho atualmente está sem funcionar por falta de ligação com o oxigênio, tendo em vista que o aparelho precisa estar em bom estado e instalado corretamente para o seu uso, pois no momento estamos com dois respiradores na unidade, porém apenas um em funcionamento.

Sala das Sessões

Em, 02 de Agosto de 2021.



Leticia Correa da Silva Martins
Vereadora

DEFERIDO

Câmara Municipal de Sarapuí

Em 04/08/2021


Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

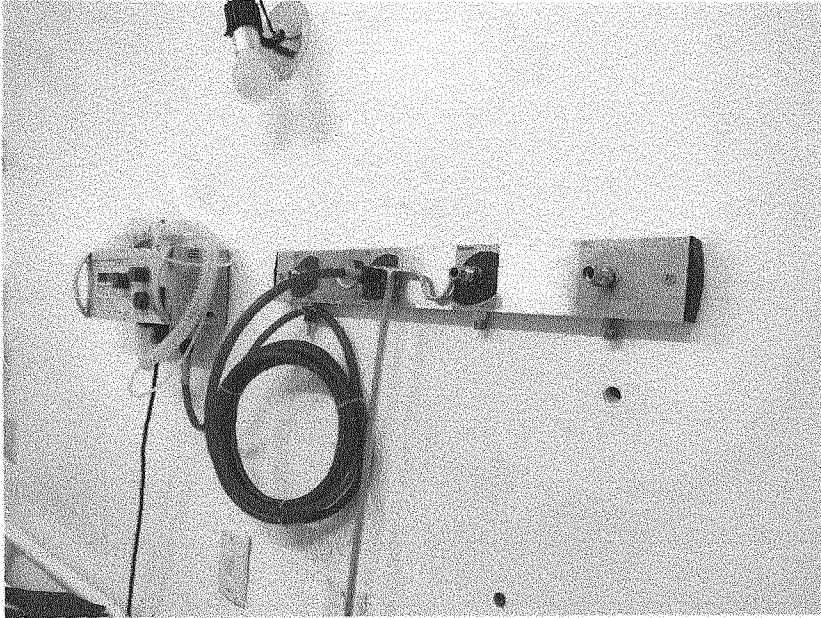
Estado de São Paulo

Plenário Alexandre Chauar

Rua Antonio Benedito de Almeida, 22

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapuí

Tel.: 3276-1488 – site: www.camarasarapui.sp.gov.br



DEFERIDO

Câmara Municipal de Sarapuí

Em 04/08/2021